


فرایند باز کردن قالب گچی در بیمارستان امام علی (ع)

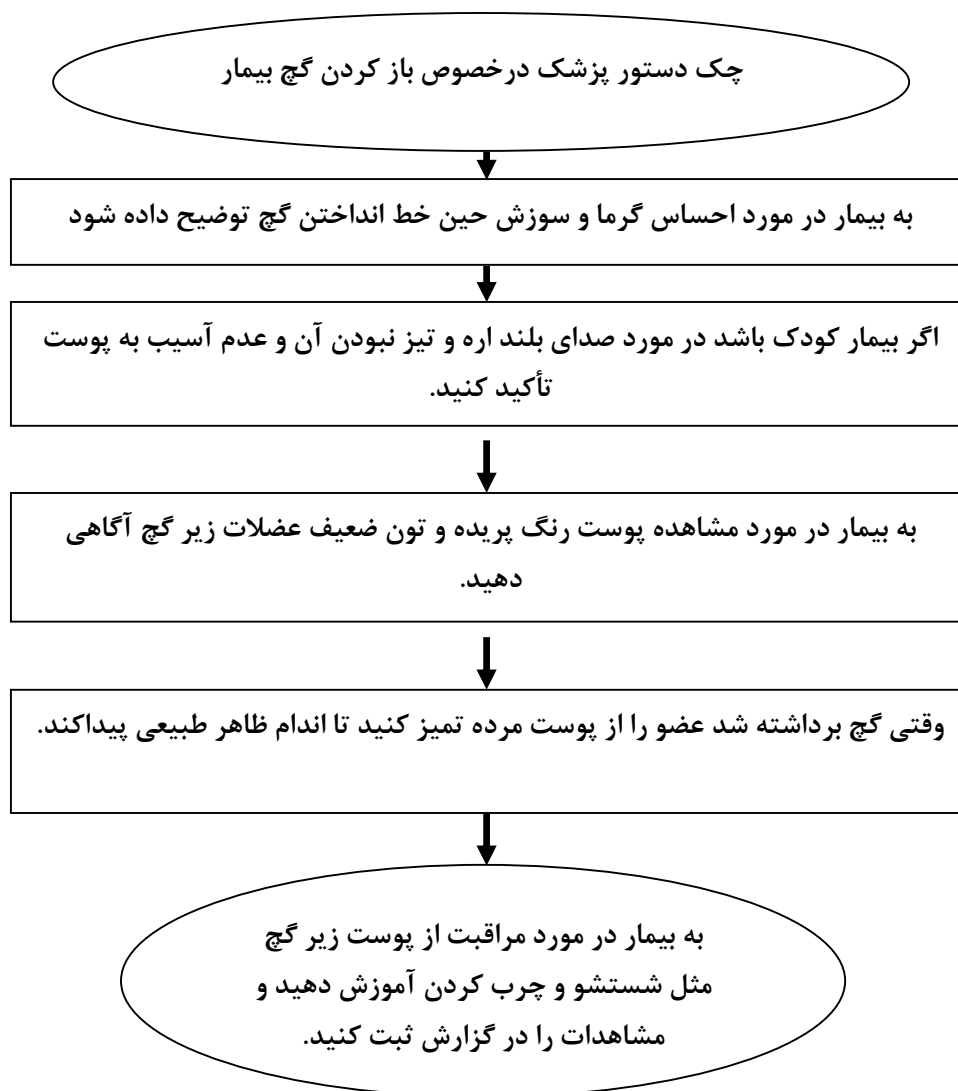

صاحبان فرآیند:

پرستار

تکنسین و کارشناس اتاق عمل

سرپرستار

کد: ف/۲۰-ب

زمان: ۲۰ دقیقه

تاریخ تنظیم: ۹۱/۱۲/۱

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۴/۱۲/۱

چک لیست تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت اجرای فرایند باز کردن قالب گچی

سال

| اسفند | بهمن | دی | آذر | آبان | مهر | شهریور | مرداد | تیر | خرداد | اردیبهشت | فروردین | عنوان |
|-------|------|----|-----|------|-----|--------|-------|-----|-------|----------|---------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | برگ دستور پزشک |
| | | | | | | | | | | | | دستگاه گچ بری |
| | | | | | | | | | | | | دستکش یکبار مصرف |
| | | | | | | | | | | | | برگ گزارش نویسی |
| | | | | | | | | | | | | لوازم التحریر |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

مسئول بخش:

امضاء: